


Istruzioni d'uso

OX2

Video otoscopio

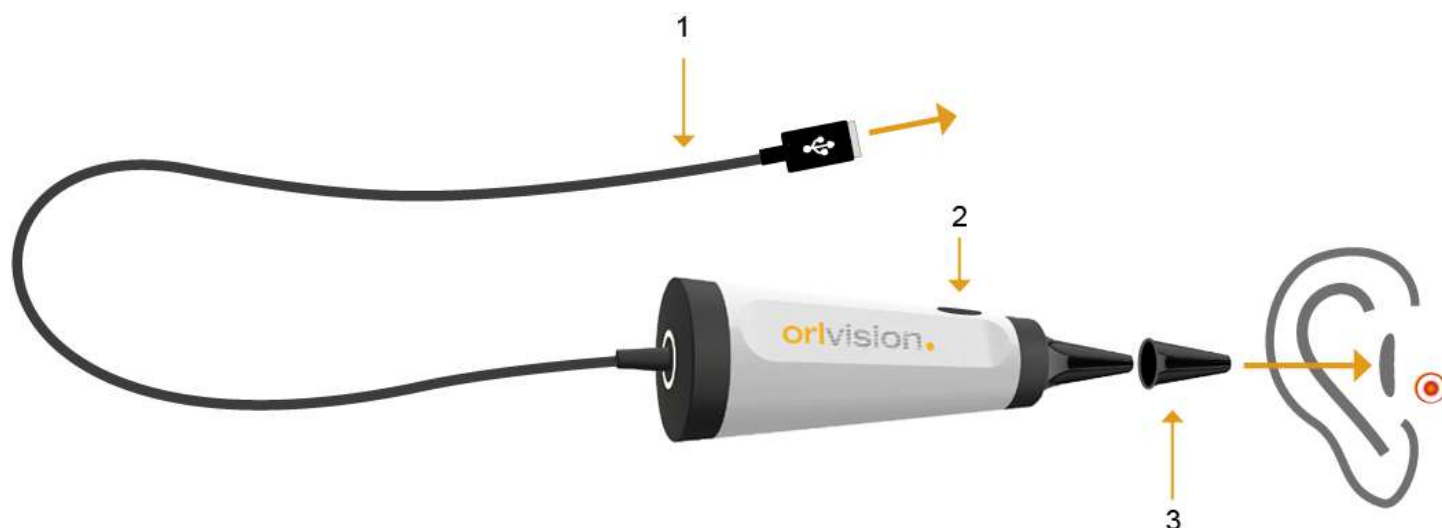

1. Cavo di collegamento con interfaccia USB: uscita dati e alimentazione a 5 V
2. Pulsante di acquisizione
3. Imbuto auricolare monouso

Contenuto

1	Avvertenze sui rischi e pericoli, simboli utilizzati.....	3
1.1	Note	3
2	Uso previsto	5
3	Simboli utilizzati.....	5
3.1	Note di utilizzo	6
3.2	Dotazione.....	6
4	Dati tecnici.....	7
5	Produttore.....	8
6	Rappresentante per la Svizzera.....	8
7	Rappresentante autorizzato per il Regno Unito.....	8
8	Accessori consigliati	9
9	Messa in funzione e utilizzo	10
9.1	Installazione di orlView	10
9.2	Inserimento dell'imbuto auricolare monouso.....	10
9.3	Spegnimentno.....	10
10	Pulizia, mantenimento e disinfezion	11
10.1	Cura	11
11	Manutenzione e riparazione	11
12	Smaltimento.....	11
13	Compatibilità elettromagnetica	11
13.1	Informazioni sull'ambiente operativo:	11
13.2	Informazioni sulle caratteristiche prestazionali.....	11
14	Segnalazione di incidenti gravi.....	12

1 Avvertenze sui rischi e pericoli, simboli utilizzati

1.1 Note



Attenzione:

Utilizzare l'otoscopio solo per lo scopo previsto, in conformità alle norme mediche, alle regole tecniche generalmente riconosciute e alle norme di sicurezza sul lavoro e di prevenzione degli infortuni.



Attenzione:

Prima di utilizzare l'otoscopio, ispezionarlo visivamente per verificare che funzioni correttamente e sia in buone condizioni. L'otoscopio è uno strumento ottico meccanico di precisione di alta qualità; trattarlo con cura.



Attenzione:

Non utilizzare l'otoscopio se presenta difetti che possano mettere in pericolo i pazienti, gli utenti o terzi, come ad esempio bordi taglienti dovuti a danneggiamenti



Attenzione:

Prima di ogni utilizzo dell'otoscopio, accertarsi che l'immagine sia riprodotta correttamente osservando un oggetto campione.



Attenzione:

Assicurarsi che durante l'esecuzione di un esame non vengano riprodotte sullo schermo immagini precedentemente memorizzate.



Attenzione:

Evitare la luce solare diretta, i raggi X, sbalzi improvvisi e bruschi di temperatura o il riscaldamento oltre i 60 °C e sollecitazioni meccaniche come urti violenti.



Attenzione:

Non guardare direttamente nell'emissione luminosa della sorgente luminosa. L'energia delle sorgenti luminose può causare danni agli occhi.



Attenzione:

Durante il funzionamento, la punta di emissione della luce può riscaldarsi fino a 10°C al di sopra della temperatura ambiente..



Attenzione:

Per motivi igienici, si raccomanda vivamente di utilizzare l'otoscopio solo con gli imbuti auricolari monouso specificati e di smaltirli dopo il singolo utilizzo.



Attenzione:

Utilizzare esclusivamente prodotti medici approvati, come ad esempio un PC medico (marchio di prova 60601-1). In caso contrario, il paziente o l'utente potrebbero essere messi in pericolo. Seguire le istruzioni del capitolo 9.



Attenzione:

La sicurezza operativa e l'utilizzo del dispositivo medico dipendono non solo dalla propria abilità, ma anche dalla cura del dispositivo. Sono pertanto necessarie una pulizia e manutenzione regolari (Vedere il capitolo Pulizia, mantenimento e disinfezione).



Attenzione:

L'assistenza qualificata e l'uso di ricambi originali garantiscono il mantenimento della sicurezza operativa, dell'uso e del valore del dispositivo medico.

2 Uso previsto

Gli otoscopi di **orlvision** GmbH (di seguito "orlvision") sono prodotti medici di alta qualità. Vengono utilizzati per esami medici dell'orecchio umano. Gli otoscopi possono essere utilizzati per esaminare il canale uditivo esterno. Le regioni d'esame possono essere visualizzate su schermi ad alta risoluzione e le immagini possono essere memorizzate. L'otoscopio è da utilizzare esclusivamente negli studi medici e nelle cliniche, nonché negli studi audiologici e audioprotesisti.

All'estremità distale dell'otoscopio si trova l'uscita di un conduttore di luce che illumina la regione di osservazione. Un obiettivo collegato consente di acquisire immagini con un angolo di visione di 60°. L'immagine così catturata viene registrata da una videocamera, convertita in un segnale elettrico e resa disponibile all'uscita dell'otoscopio come segnale digitale USB. La luce per illuminare la regione di osservazione è generata da un LED integrato nell'otoscopio. L'estremità dell'otoscopio è formata da un manicotto staccabile, di seguito denominato punta monouso.

L'alimentazione elettrica viene fornita collegandosi a un PC medico tramite l'interfaccia USB.

È necessario installare preventivamente il software di visualizzazione delle immagini orlView in dotazione, con il quale è possibile visualizzare e salvare immagini e video.






Attenzione:

Si tratta di un sistema elettronico che deve essere protetto dall'umidità.

3 Simboli utilizzati

I simboli utilizzati hanno il seguente significato:

	Sulla targhetta: attenzione, seguire le istruzioni d'uso
	Simbolo per la raccolta differenziata di apparecchiature elettriche ed elettroniche
	Nelle istruzioni d'uso: Attenzione, fonte di pericolo
IP 65	Il prodotto è resistente alla polvere e all'immersione permanente
MD	Il prodotto è un dispositivo medico

3.1 Note di utilizzo

Le presenti istruzioni per l'uso spiegano come utilizzare il dispositivo medico in modo sicuro, corretto ed efficace. Prima di mettere in funzione il dispositivo, leggere le istruzioni d'uso, partendo dal capitolo sulle avvertenze di rischio e pericolo.

Le istruzioni d'uso non sostituiscono le adeguate conoscenze mediche e tecniche di base. L'utente deve acquisire tali conoscenze in speciali corsi di formazione avanzata.

Orlvision non si assume alcuna responsabilità per le diagnosi e le interpretazioni dei risultati effettuati con l'ausilio di prodotti medici acquistati da orlvision. L'acquisizione di competenze mediche e le relative conseguenze diagnostiche e terapeutiche sono di esclusiva responsabilità dell'utente del prodotto medico.

L'otoscopio può essere utilizzato solo da personale specializzato all'uso del dispositivo.

In particolare, orlvision non fornisce alcuna garanzia nel caso in cui l'otoscopio venga collegato a un altro computer per la visualizzazione delle immagini.

3.2 Dotazione

La dotazione comprende:

- Manipolo con punta monouso
- Staffa (utilizzabile come staffa da tavolo o da parete)
- Istruzioni d'uso
- Software / Visualizzatore "orlView" su chiavetta USB



Immagine 1:
Otoscopio nel supporto

4 Dati tecnici

Parametro	Dati
Area di messa a fuoco	3 – 50 mm
Angolo visivo	90°
Diametro estremità distale	Imbuto auricolare monouso da 4,0 mm
Lunghezza totale	130 mm
Auflösung in Pixel	400 x 400
Illuminazione: LED	Conduttore di luce
Alimentazione	5 V DC via USB
Consumo energetico senza USB	max. 0,1 A
Interfaccia	USB 2.0
Peso in g	circa 130 g
Classe di rischio secondo MDR	1
Tempertaura di trasporto e stoccaggio in ° Celsius	Da - 10° a + 70°
Temperatura di esercizio in °Celsius L'estremità distale può riscaldarsi fino a 9°C in più rispetto alla temperatura ambiente.	Da 0° a + 40°
Umidità relativa	Da 0 a 95%
Pressione atmosferica	Da 950 a 1050 hPa
Classe di protezione contro scosse elettriche	Classe II
Modalità di funzionamento	Servizio continuo
Classe di protezione	IP65

5 Produttore

Il produttore del otoscopio OX2 è



orlvision GmbH
Gewerbstraße 17
D-35633 Lahnau

Tel.: +49 (0) 64 41 67 92 98 - 0
Fax.: +49 (0) 64 41 67 92 98-99

info@orlvision.de
www.orlvision.de

6 Rappresentante per la Svizzera



Pfenniger Medizintechnik GmbH
Parkstrasse 25, CH-6410 Goldau

Tel.: +41 41 530 51 15
info@pfenniger-medizintechnik.ch

7 Rappresentante autorizzato per il Regno Unito



Jeremy Taylor, LiteOptics Ltd,
The Nucleus, Chesterford Research Park,
Little Chesterford, Essex CB10 1XL

Tel +44 (0) 1799 542716
enquiries@liteoptics.com

8 Accessori consigliati

Punta monouso:

raccomandiamo: produttore Kirchner & Wilhelm GmbH + Co KG; tipo di imbuto auricolare grigio (opzionale Ø 2,5 mm N. ordine: 01.71212.002) o Ø 4,0 mm N. ordine: 01.71222.002).

9 Messa in funzione e utilizzo

9.1 Installazione di orlView

Utilizzare la chiavetta USB in dotazione con un PC medico. Selezionare il file setup.exe e seguire le istruzioni di installazione sullo schermo. Selezionare l'otoscopio per l'installazione.

Per il funzionamento del software, consultare le istruzioni fornite separatamente.

9.2 Inserimento dell'imbuto auricolare monouso



Attenzione:

Inserire con cautela l'imbuto auricolare monouso nell'orecchio esterno. Per motivi igienici, non utilizzare mai l'otoscopio senza un'imbuto auricolare monouso.

Al termine dell'esame, ritirare con cautela l'otoscopio.

9.3 Spegnimento

Dopo l'uso, scollegare l'otoscopio dal PC medico. Eseguire quindi le operazioni di pulizia e disinfezione necessarie.

Si veda il capitolo 10.

10 Pulizia, mantenimento e disinfezion



Attenzione:

L'immersione duratura dell'otoscopio in alcol concentrato può provocare danni irreversibili. Se necessario, eseguire una breve disinfezione con un panno. Tuttavia, assicurarsi assolutamente che l'alcol possa evaporare dopo la disinfezione del panno.

10.1 Cura

L'otoscopio è di facile manutenzione. Oltre a una pulizia accurata e a un'ispezione periodica per verificare la presenza di eventuali danni, non sono necessarie cure particolari. L'otoscopio deve essere conservato in un luogo asciutto e protetto dalla polvere.

11 Manutenzione e riparazione

I lavori di riparazione e manutenzione possono essere eseguiti solo dalla società orlvision o da ditte specializzate da essa autorizzate.

La società **orlvision** fornisce alle aziende autorizzate tutta la documentazione necessaria sui prodotti.

Attenzione: l'apertura, la riparazione e le modifiche non autorizzate dell'otoscopio durante il periodo di garanzia, esonerano la società **orlvision** da qualsiasi responsabilità in materia di sicurezza operativa, e pertanto ne annullerà qualsiasi richiesta..

12 Smaltimento



Smaltimento ecologico secondo la Direttiva UE 2012/19/UE. L'apparecchio contiene componenti elettronici. Per evitare rischi o pericoli ambientali dovuti a uno smaltimento improprio, il prodotto, compresi gli accessori, deve essere smaltito in conformità alle direttive UE 2012/19/UE applicabili. Lo smaltimento può essere effettuato dal produttore.

A tal fine, si prega di inviare al produttore all'indirizzo:

orlvision GmbH,
Gewerbestraße 17,
D-35633 Lahnau.

È vietato lo smaltimento nei rifiuti domestici.

13 Compatibilità elettromagnetica

13.1 Informazioni sull'ambiente operativo:

L'otoscopio è destinato ad ambienti a bassa interferenza RF, come gli studi medici. Non è necessario un luogo schermato.

13.2 Informazioni sulle caratteristiche prestazionali

- **Le caratteristiche essenziali** dell'otoscopio sono: Visualizzazione delle immagini della regione in esame (orecchio medio). La qualità dell'immagine può essere compromessa in presenza di forti interferenze elettromagnetiche.
- **Avvertenza:** L'uso di questa unità nelle immediate vicinanze di altre unità o con altre unità impiantate deve essere evitato in quanto potrebbe causare interferenze.
- Cavi, trasformatori e accessori che possono essere sostituiti senza influire sulla compatibilità elettromagnetica: Nessuno
- **Warnung:** Die Verwendung von anderem Zubehör (insbesondere PC) kann zu einer fehlerhaften Betriebsweise führen
- **Avvertenza:** il funzionamento di apparecchiature di comunicazione (radio) portatili nelle immediate vicinanze può causare un funzionamento non corretto.

14 Segnalazione di incidenti gravi

Tutti gli incidenti gravi occorsi con questo prodotto devono essere segnalati al produttore e all'autorità competente dello Stato membro in cui è stabilito l'utilizzatore e/o il paziente.

Orlvision GmbH
Gewerbestr. 17
D-35633 Lahnau

Tel. +49(0)6441679298-0
Fax +49(0)6441679298-99

info@orlvision.com
www.orlvision.com

Rev. 17 de 27.06.2024

